


# 圖一：公稱容量的量度方法

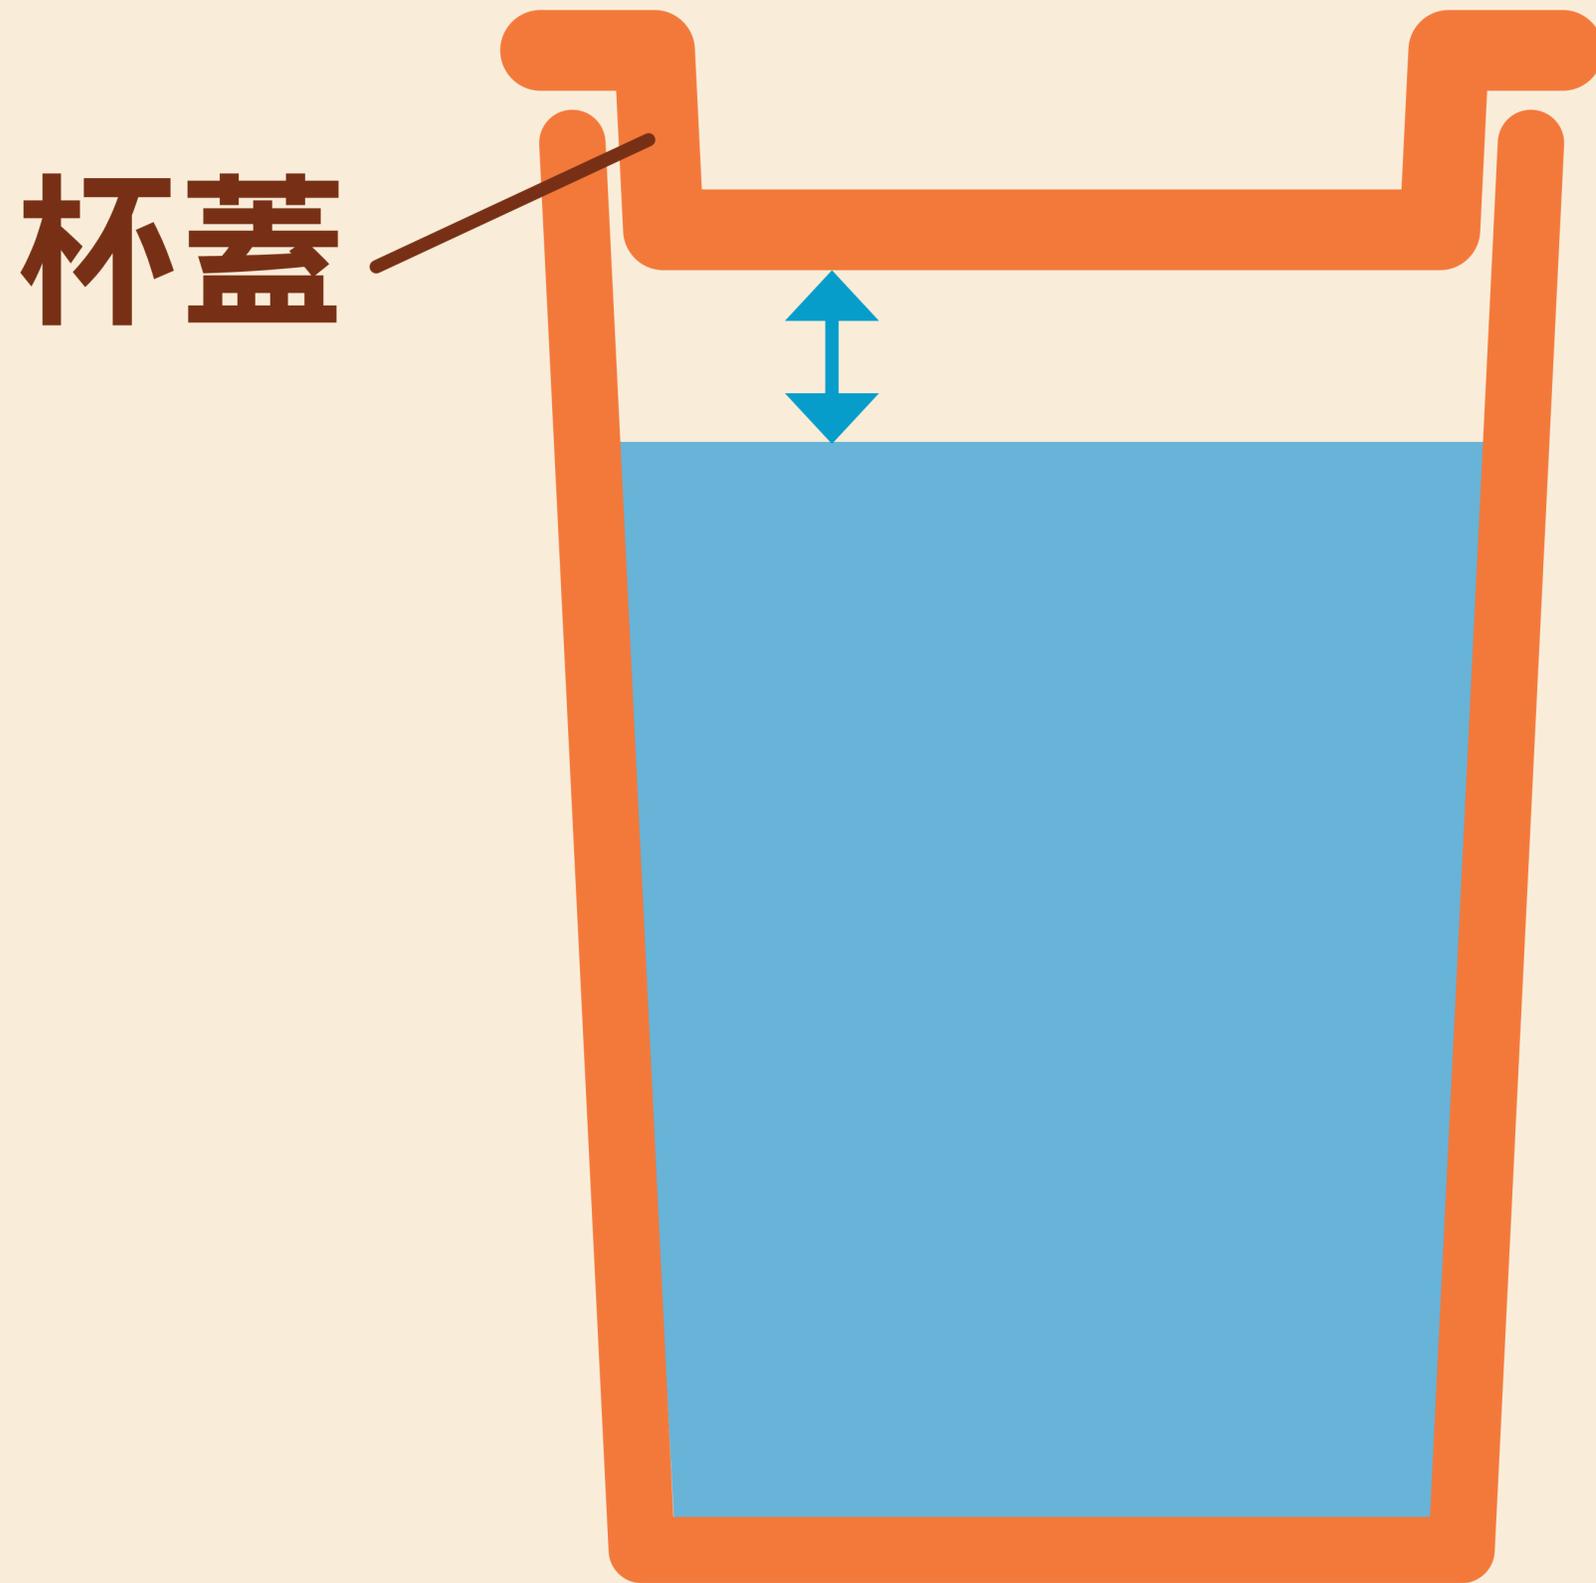

實驗室參考歐洲標準方法量度樣本的公稱容量，意思指量度關上杯蓋後，杯蓋插入杯內最低位置以下 10 毫米水平的容量。